


LaboTexが起動できない


TCP/IPポート1947の競合

1. 最新のSmartLab測定ドライバーとの競合
2. 他のアプリケーションとの競合

確認 localhost:1947

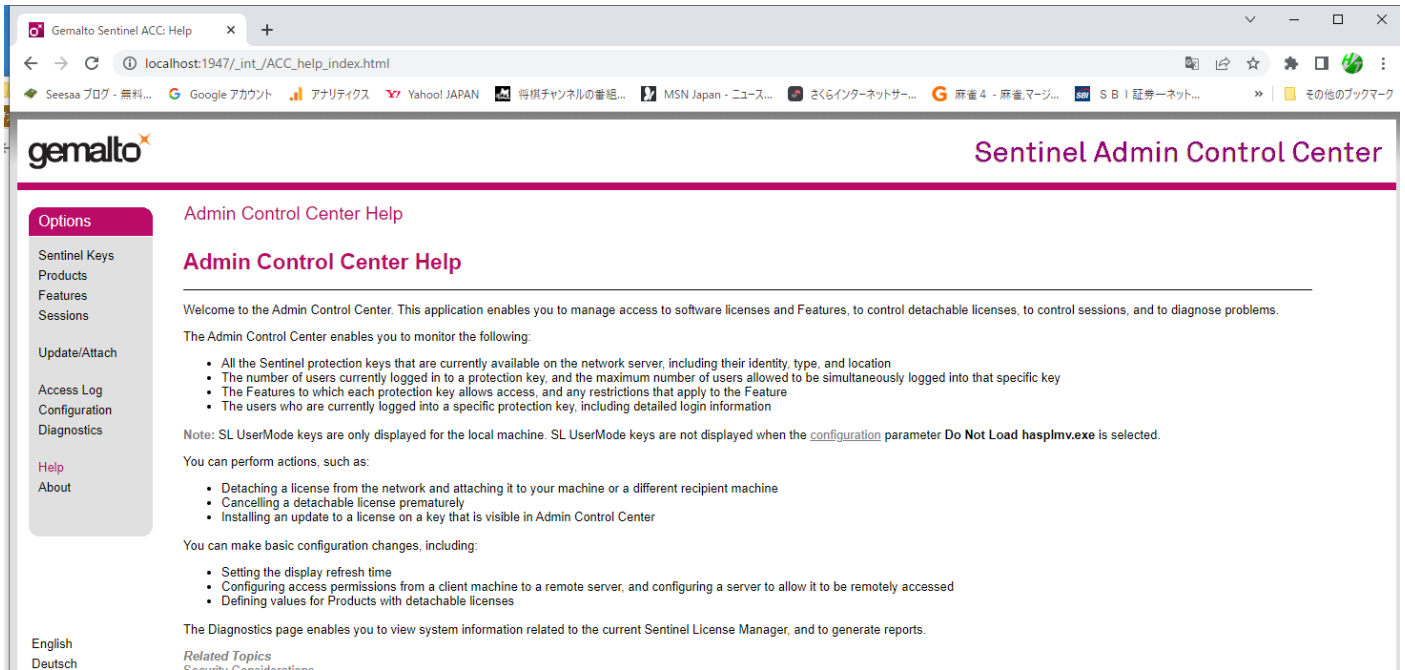

LaboTex 以外が表示されている場合

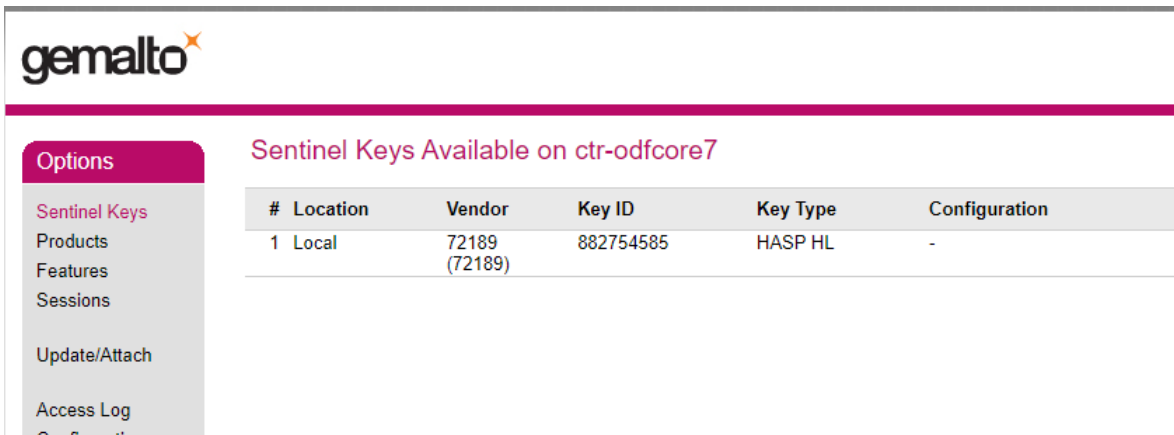

競合しています。